

股票代號:6228



全譜科技股份有限公司

2022年法人說明會

中華民國111年12月8日

大綱

- 免責聲明
- 公司簡介
- 組織功能
- 主要產品及應用
- 研發成果
- 2018 ~ 2021年度經營實績
- 2022年前3季經營實績
- 產業現況及公司未來展望
- Q&A

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

公司簡介

1993 公司成立
2003 臺灣證券市場上櫃

總公司：台灣新北市汐止區
美國子公司：洛杉磯
董事長：高偉超
總經理：曾治元
財務長：陳素花

底片掃描器
凝膠影像系統
臨床診斷檢測器



公司發展里程碑

1993

多功能事務機

初創

1999



底片掃描器

找到掃描器藍海


2004



凝膠影像系統

轉型生技領域
從研究市場入門

2017




診斷檢測器

建材
裝潢

進入到臨床檢
測領域
及多角化

組織功能

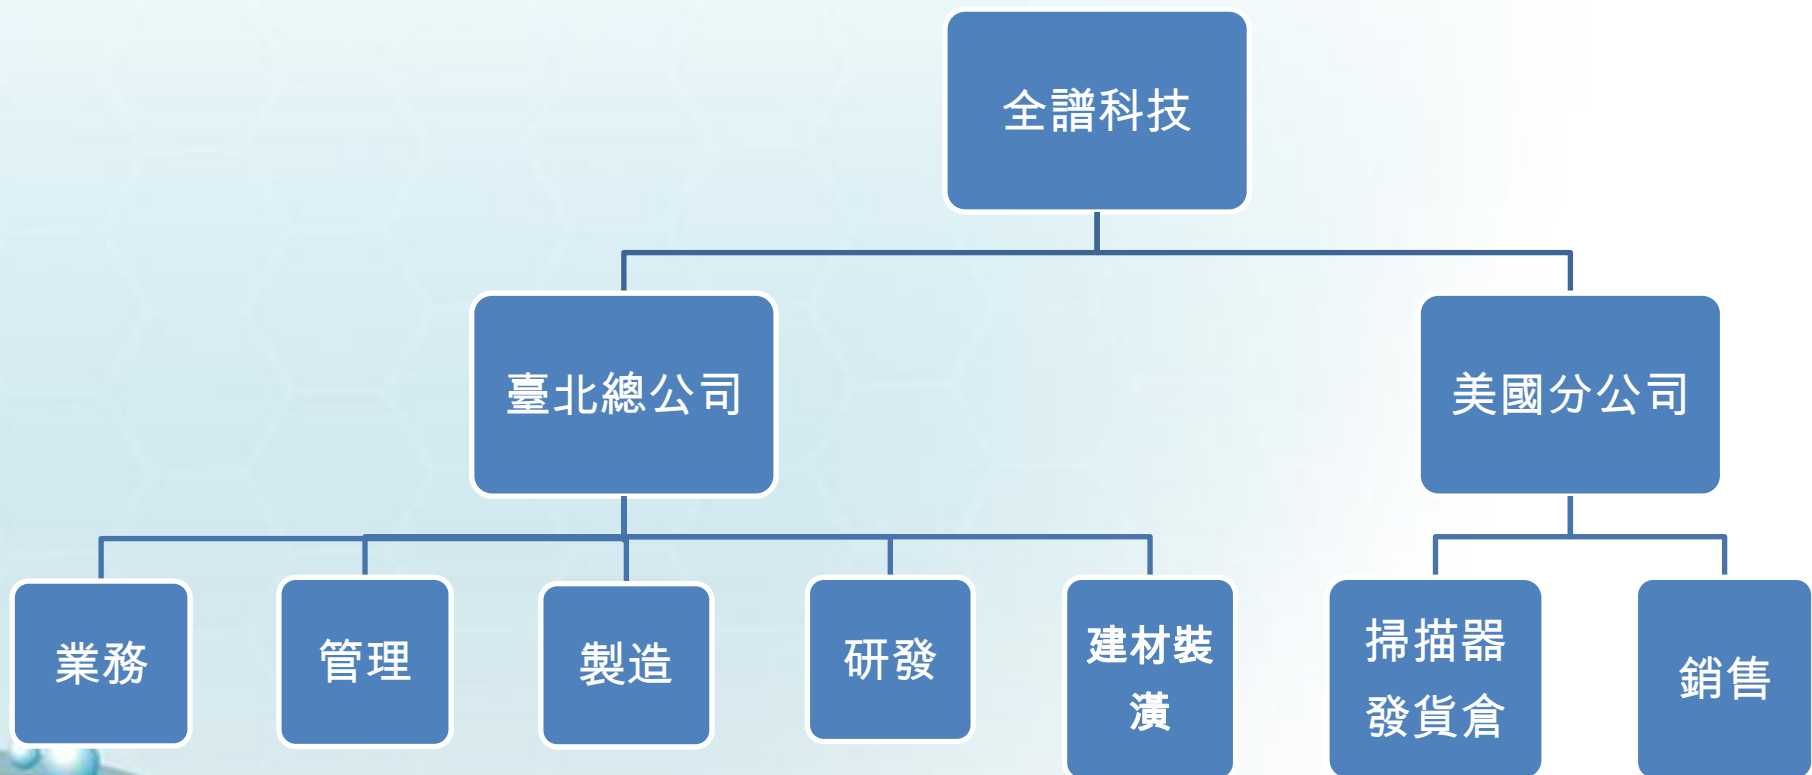

主要產品線與相關應用





底片掃描器



凝膠影像系統



診斷檢測器

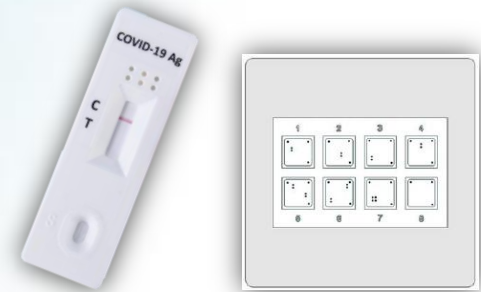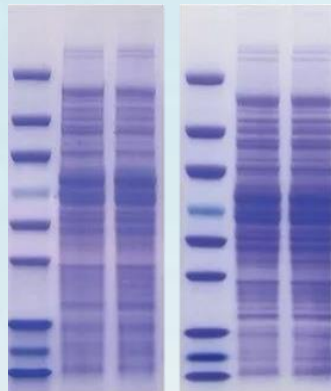

主要產品-底片掃描器



PowerFilm



PrimeFilm XAs



PowerSlide X



PrimeFilm XEs



PrimeHisto XE



PrimeFilm 120 pro

主要產品-凝膠影像系統



GelCap



Glite T8



Glite 600



Slite 600



ChemLux

主要產品-診斷檢測讀取儀



DSK開發工具



PC讀取儀



ONE讀取儀




ST5讀取儀

POCT

- 底片掃描器
 - 業界最完全的底片對應方案
 - 光學解析度5,000 dpi遠高於其他競爭者
- 凝膠影像系統
 - 從最小的手機方案到最大最全的可見光/螢光/冷光方案備齊
- 診斷檢測讀取儀
 - 從開發工具到各式臨床檢測機台方案高度整合

2018-2021經營實績

單位: 新台幣仟元

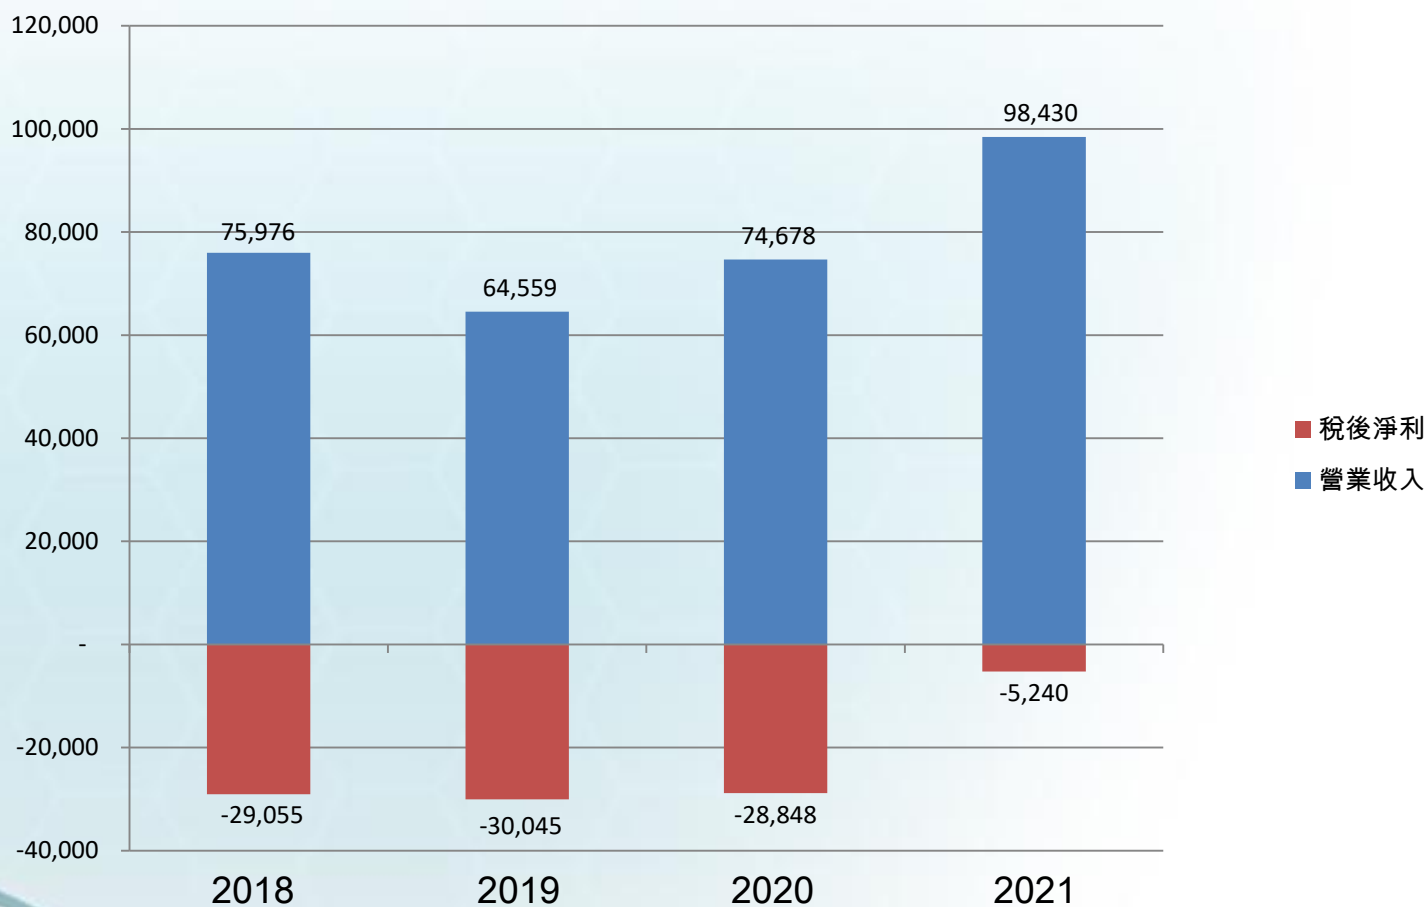

2022Q1-Q3與2021同期合併綜合損益 表比較



單位: 新台幣仟元

項目	2022年Q1-Q3	2021Q1-Q3	兩期差異
銷貨收入	32,796	66,991	(34,195)
銷貨成本	23,819	34,525	(10,706)
銷貨毛利	8,977	32,466	(23,489)
營業費用	32,729	38,919	(6,190)
營業淨利(損)	(23,752)	(6,453)	(17,299)
營業外收入及(支出)	7,316	(2,445)	9,761
稅前淨利(損)	(16,436)	(8,898)	(7,538)
所得稅費用	(1,743)	(377)	(1,366)
稅後淨利(損)	(18,179)	(9,275)	(8,904)
其他綜合(損)益	2,934	(416)	3,350
本期綜合(損)益總額	(15,245)	(9,691)	(5,554)
每股盈餘(虧損)	(0.45)	(0.24)	(0.21)

2021與2020年度合併綜合損益表比較



單位：新台幣仟元

項目	2021年度	2020年度	兩期差異
銷貨收入	98,430	74,678	23,752
銷貨成本	47,041	55,873	(8,832)
銷貨毛利	51,389	18,805	32,584
營業費用	51,946	45,222	6,724
營業淨利(損)	(557)	(26,417)	25,860
營業外收入及(支出)	(3,797)	(1,646)	(2,151)
稅前淨利(損)	(4,354)	(28,063)	23,709
所得稅費用	(886)	(785)	(101)
稅後淨利(損)	(5,240)	(28,848)	23,608
其他綜合(損)益	(183)	(968)	785
本期綜合(損)益總額	(5,423)	(29,816)	24,393
每股盈餘(虧損)	(0.13)	(0.85)	0.72

經營實績-地區別營業收入比較

單位：新台幣仟元

銷售地區別	2022年Q1-Q3	2021年Q1-Q3	成長比例
亞洲	14,474	22,405	-35.4%
北美	8,572	34,657	-75.3%
歐洲	9,750	9,929	-1.8%
總計	32,796	66,991	-51.0%


銷售地區別	2021年度	2020年度	成長比例
亞洲	31,069	26,356	17.9%
北美	45,572	37,302	22.2%
歐洲	21,789	11,020	97.7%
總計	98,430	74,678	31.8%

經營實績-產品別營業收入比較


單位：新台幣仟元

產品別	2022年 Q1-Q3	2021年 Q1-Q3	成長比例
掃描器系列產品	15,041	41,606	-63.8%
凝膠成像儀系列產品	14,213	19,557	-27.3%
快篩讀取儀系列產品	1,659	3,051	-45.6%
建材(淨額法)	1,883	2,777	-32.2%
總計	32,796	66,991	-51.0%
產品別	2021年度	2020年度	成長比例
掃描器系列產品	62,306	45,382	37.3%
凝膠成像儀系列產品	23,184	20,858	11.2%
快篩讀取儀系列產品	3,984	7,471	-46.7%
建材(淨額法)	8,956	967	826.2%
總計	98,430	74,678	31.8%

從核心技術延伸

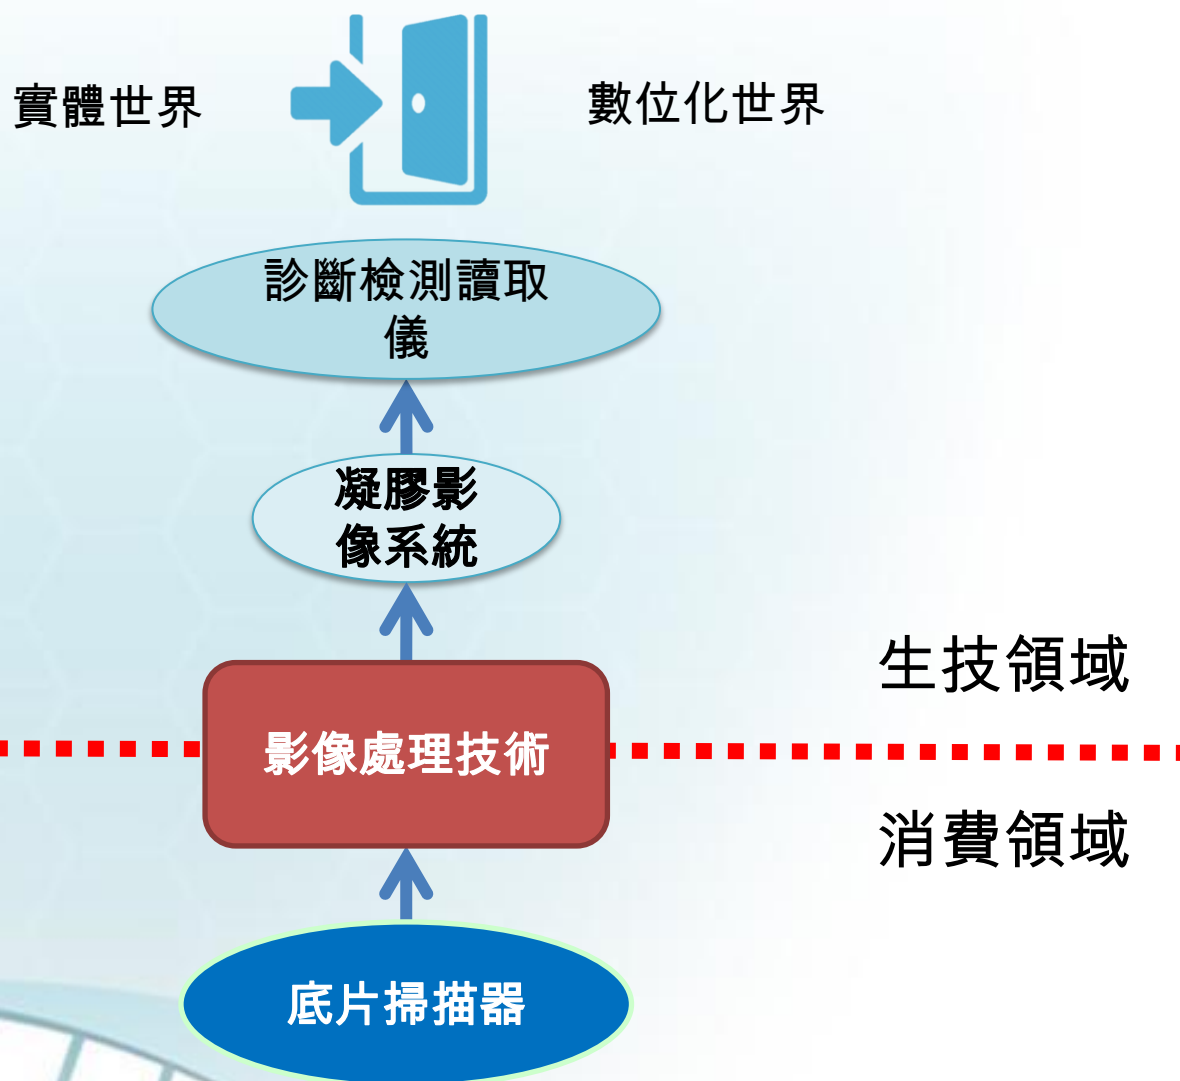

現在: 檢測平台

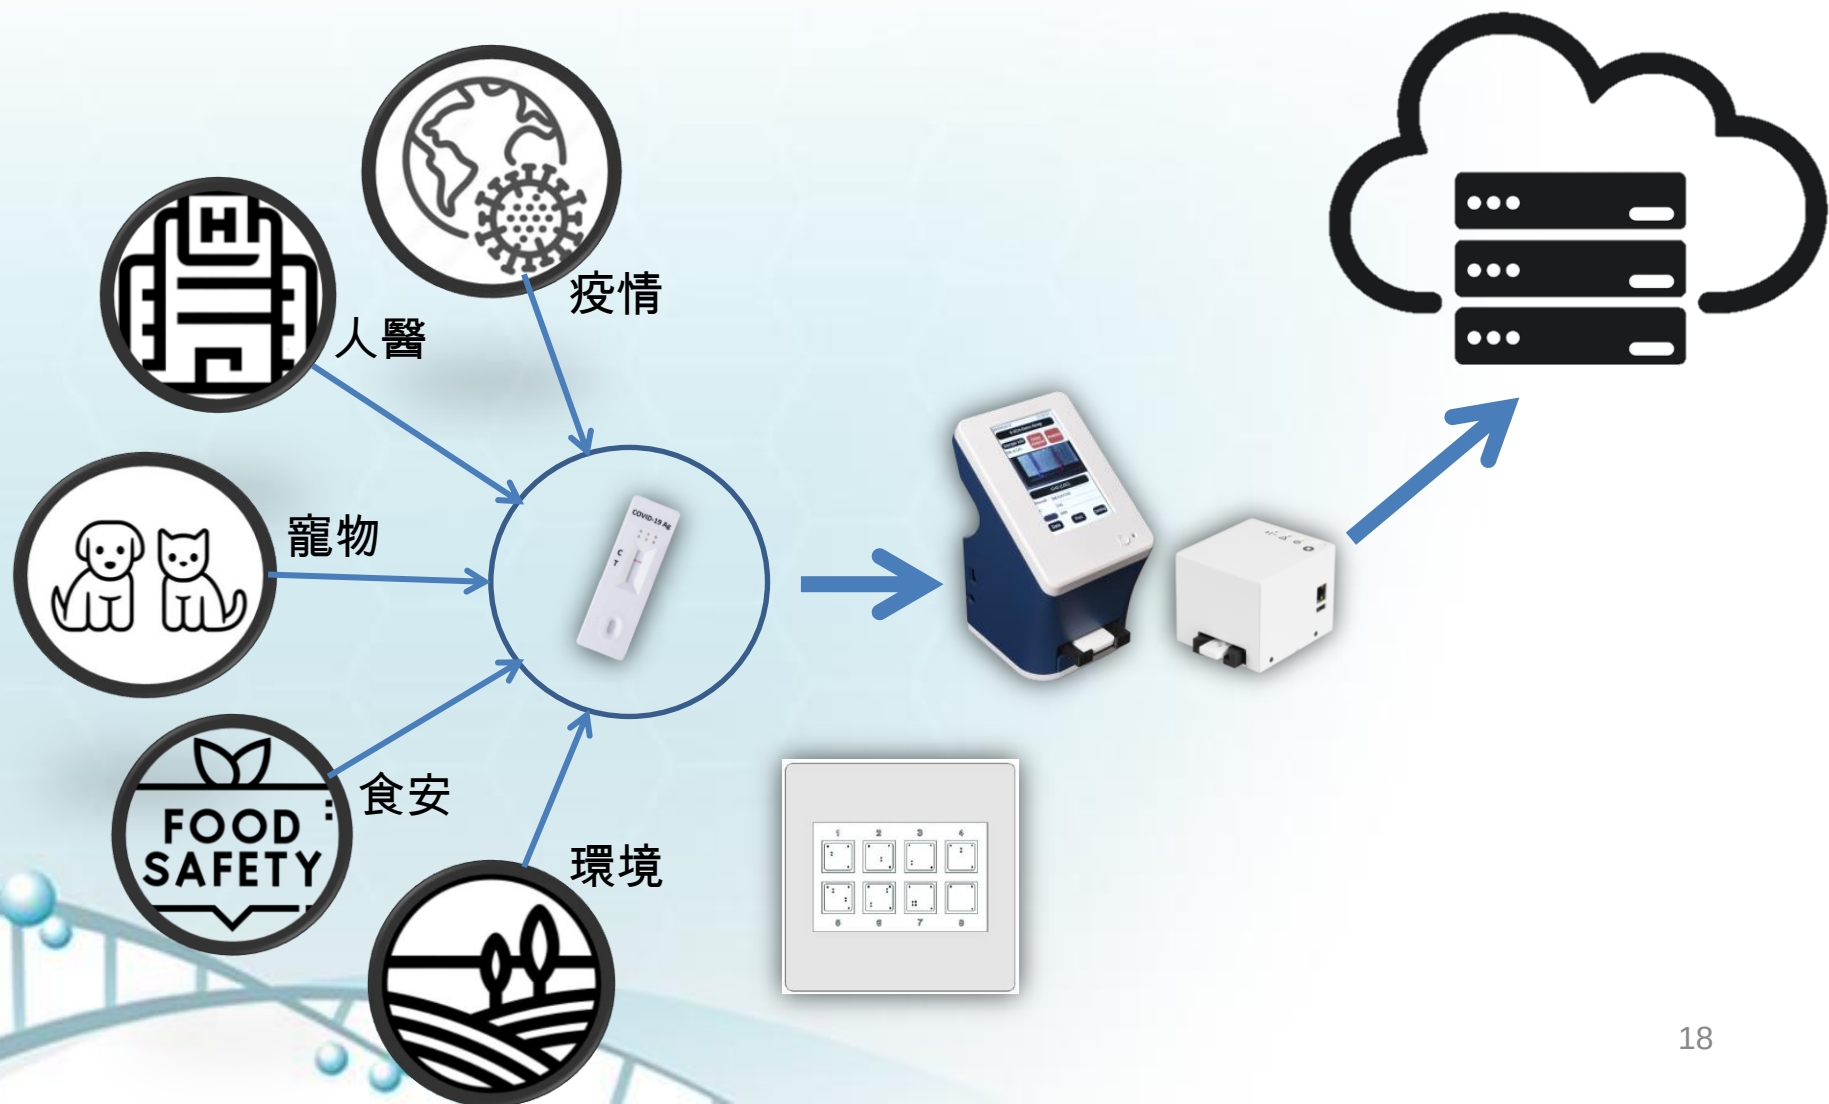

WHO : 徵詢快檢讀取儀



Health Topics ▾

Countries ▾


Newsroom ▾

Emergencies ▾

Data ▾

About WHO ▾

Home / Newsroom / Article / Call for public consultation - Target Product Profile (TPP) for readers of rapid diagnostic tests (RDT readers)

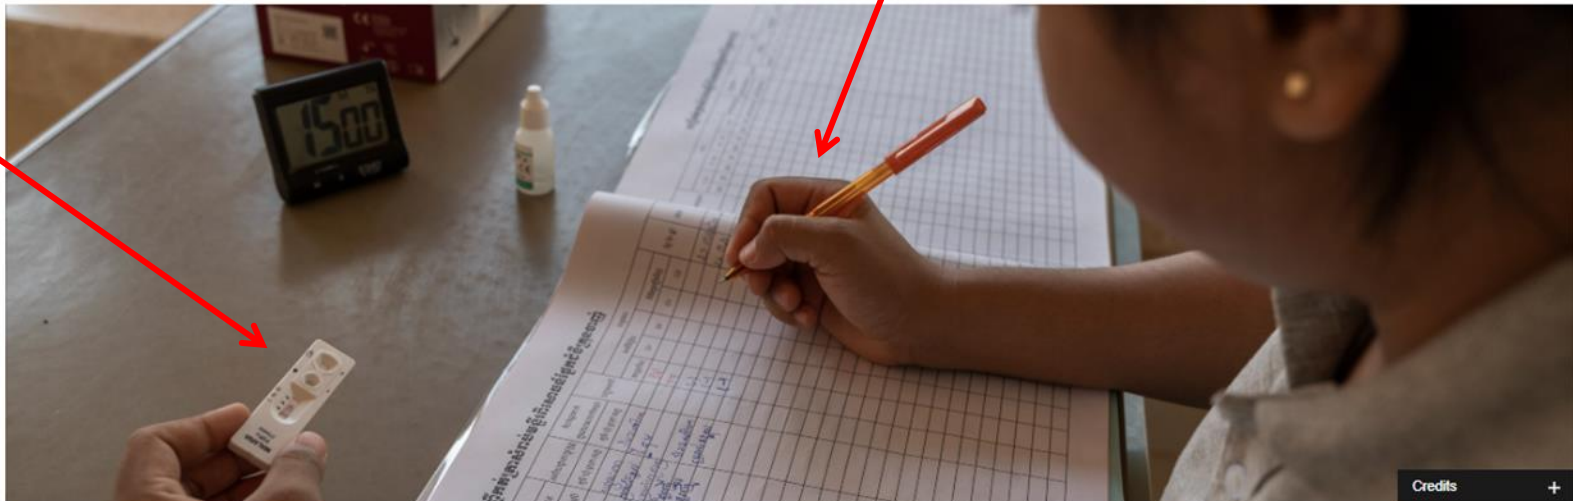

Call for public consultation - Target Product Profile (TPP) for readers of rapid diagnostic tests (RDT readers)

19 August 2022 | Call for consultation

Related Highlight

[Submission form](#)

[Draft -Target Product
Profile \(TPP\) for readers of
rapid diagnostic tests \(RDT
readers\)](#)


快檢通報系統



@ 政府



登入及測試資料上傳

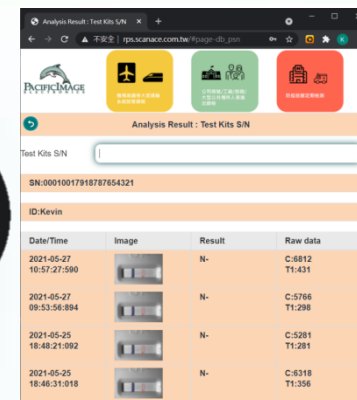


Date/Time	Image	Result	Raw data
2021-05-27 10:57:27:590		N-	C:6812 T1:431
2021-05-27 09:53:56:894		N-	C:5766 T1:296
2021-05-25 18:48:21:092		N-	C:5291 T1:281
2021-05-25 18:46:31:018		N-	C:6318 T1:356



個人或機構

從核心技術到應用導向

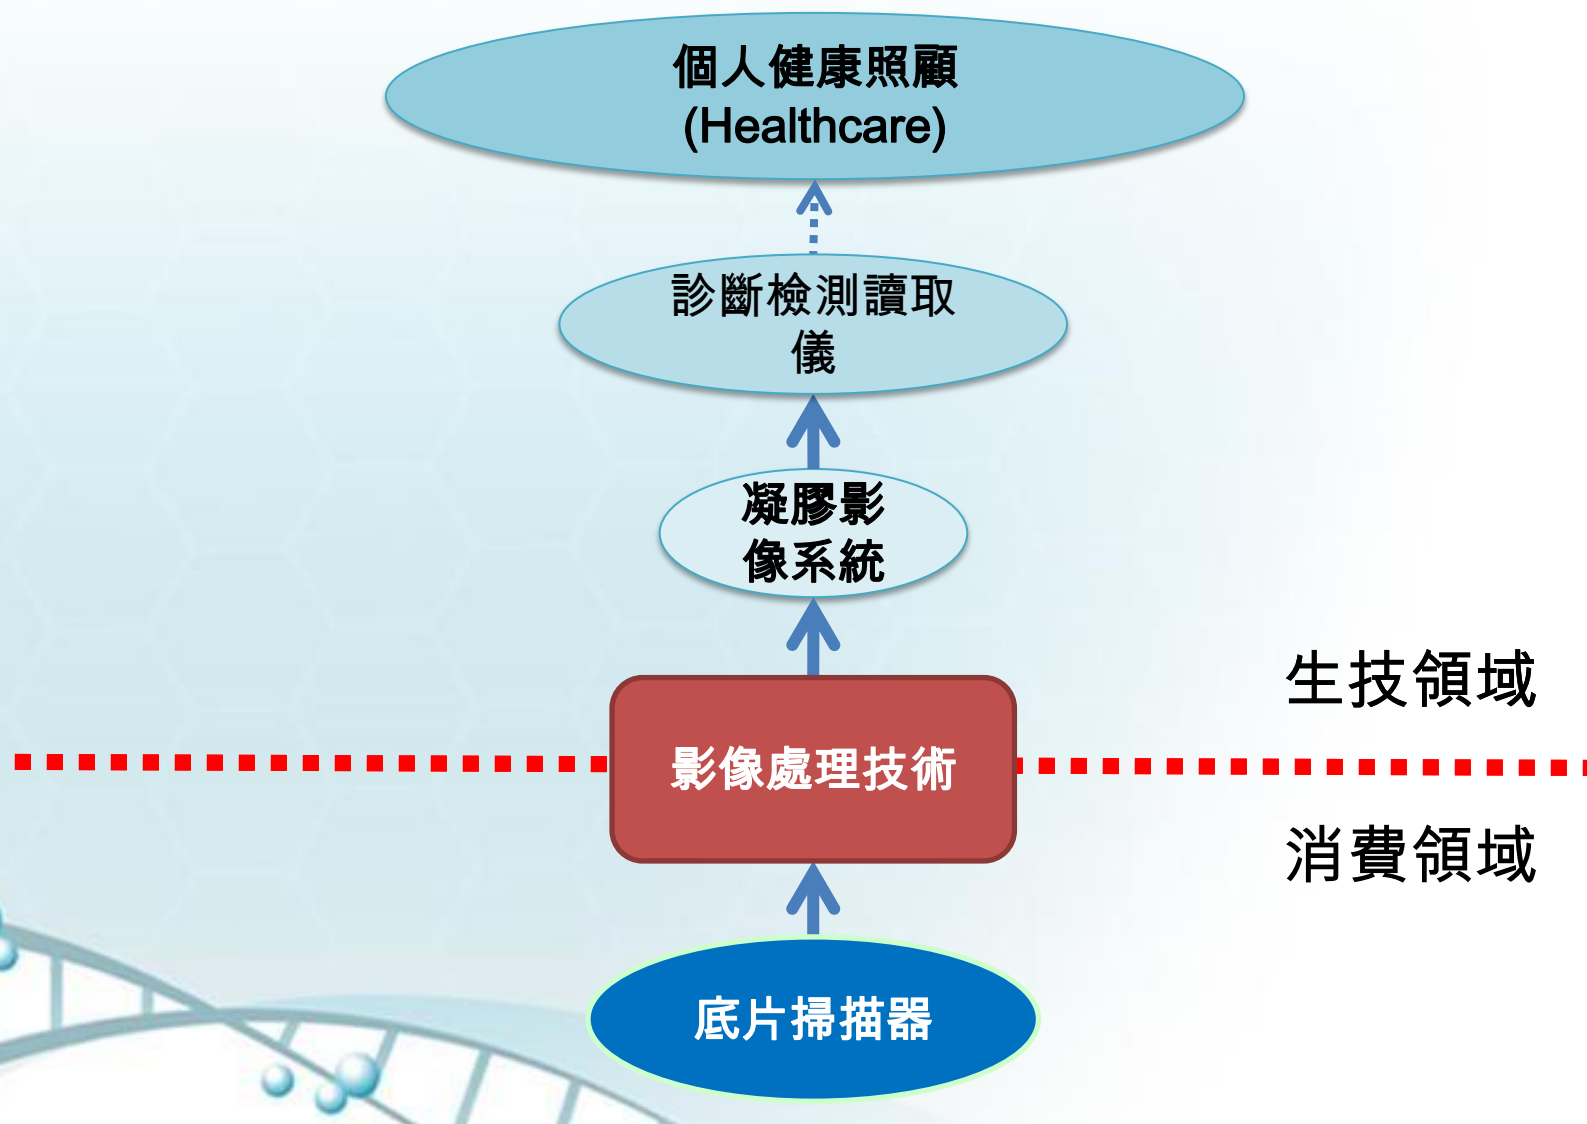

未來：個人及家用健康照護



客製的耗材

特定的應用

- 持續追蹤
- 回饋

雲端服務



Q & A